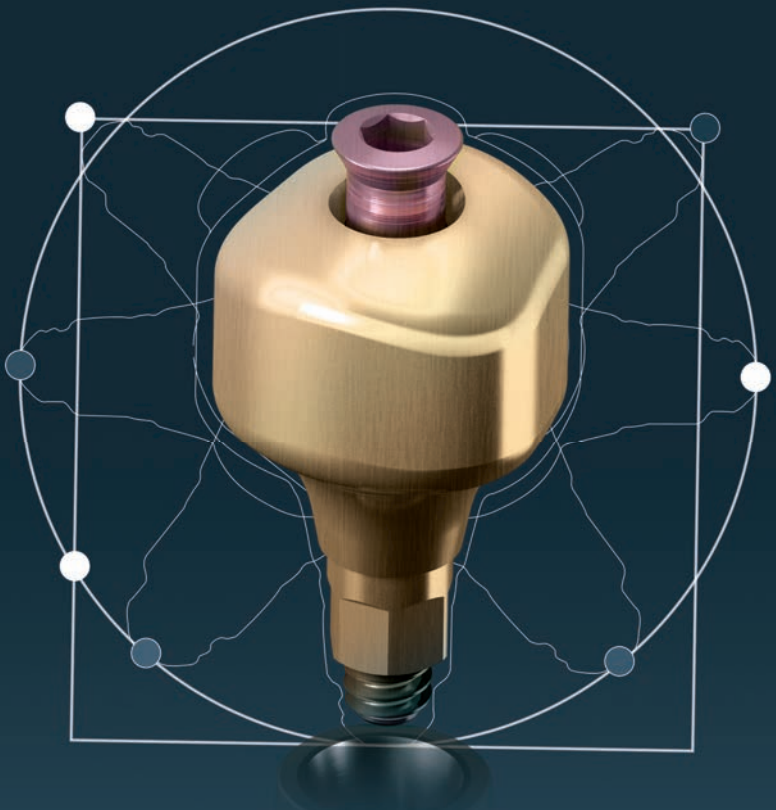

LE CODE iphysio®

TOUT CE QUE VOUS DEVEZ SAVOIR
POUR SIMPLIFIER
LE TRAITEMENT IMPLANTAIRE

PROFILE DESIGNER

iphysio®

Le protocole nouvelle génération qui améliore, fiabilise et pérennise le résultat de votre traitement implantaire en même temps qu'il le simplifie. Issue de la synthèse des expertises de LYRA ETK en implantologie et digital, cette solution anatomique 3 en 1 : pilier de cicatrisation, scanbody et pilier provisoire, devient l'élément central et unique d'un protocole simplifié sans démontage, de la cicatrisation à la prothèse. En résulte une meilleure intégration biologique qui pérennise le traitement et améliore son résultat esthétique. Il s'utilise avec la plupart des systèmes implantaires.

UNIVERSEL 10 BREVETS

PRIX DE L'INNOVATION ASSOCIATION DENTAIRE FRANÇAISE PRIX DE L'INNOVATION

Ce livret a été réalisé avec le Dr Cheylus, le Dr Koclejda, le Dr Legros et les dentistes membres du Club Actis utilisateurs d'iPhysio®, pour partager leurs expériences et leurs astuces au travers de cas cliniques.

CLUB actis
DENTISTES SCIENCES CONVIVIALITÉ

1/ CRÉER UN BERCEAU PROTHÉTIQUE ANATOMIQUE P.4

2/ RÉUSSIR SES EMPREINTES P.6

3/ PRÉSERVER LES PAPILLES GINGIVALES P.8

4/ SÉCURISER L'ADAPTATION PROTHÉTIQUE ET L'OCCLUSION P.10

5/ DEUX IPHYSIO® ADJACENTS DOIVENT ÊTRE DISJOINTS P.12

6/ FAIRE UNE PHOTO HD POUR TRANSMETTRE LES BONNES INFORMATIONS P.14

7/ BIEN COMMUNIQUER AVEC SON LABORATOIRE P.16

8/ PRÉSERVER LA RÉSINE DE VOTRE PROTHÈSE PROVISOIRE P.18

9/ ÉVITER LA MANIPULATION DES PIÈCES SUPRA-IMPLANTAIRES LORS DE L'AJUSTEMENT P.20

10/ UTILISER LA VIS POUR ENLEVER LE PROFILE DESIGNER IPHYSIO® P.22

11/ CONSERVER LE BERCEAU GINGIVAL LORS DE LA RESTAURATION FINALE P.24

12/ CONSERVER LES PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT ZIRCONE P.26

POUR ALLER PLUS LOIN : UTILISER IBONE® AVEC IPHYSIO® P.28

1

CRÉER UN BERCEAU PROTHÉTIQUE STABLE

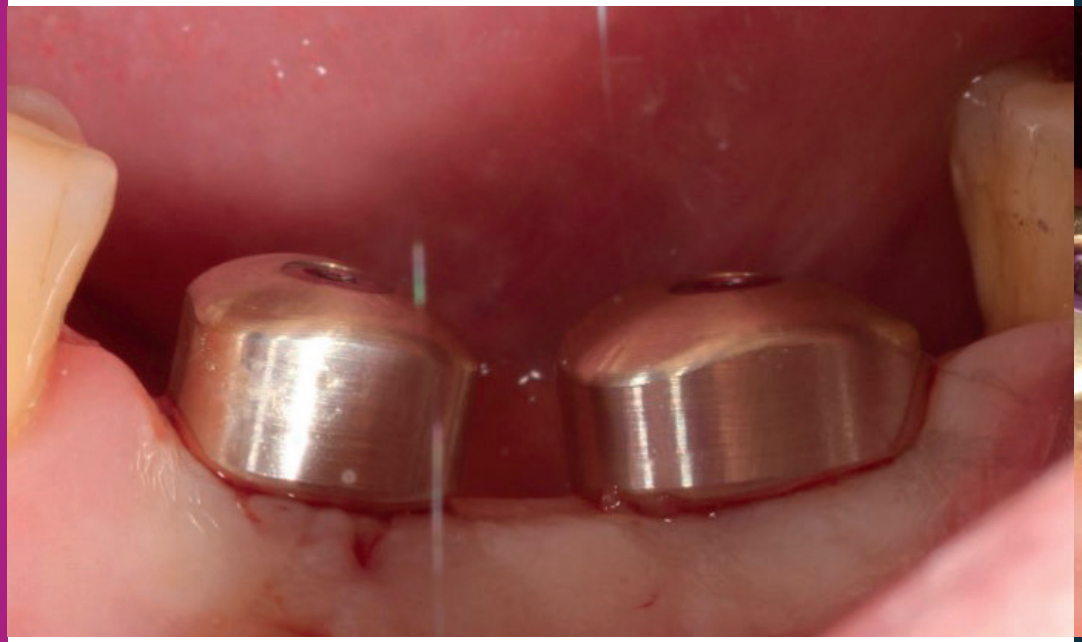

NON

OUI

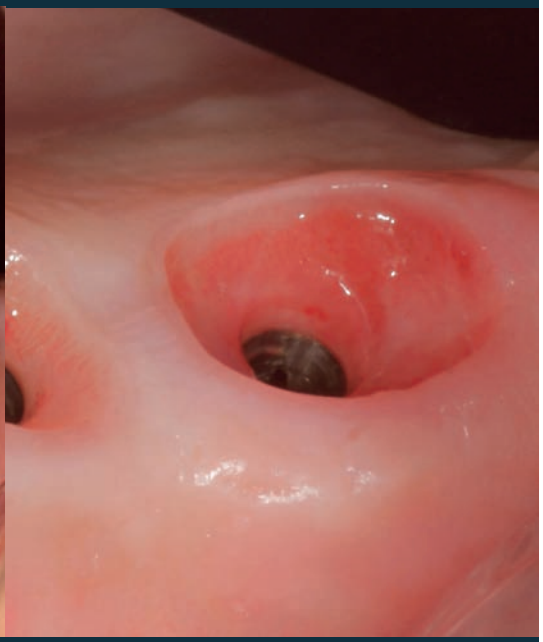

Le positionnement vertical du Profile Designer iPhysio® conditionne le berceau prothétique

Le profil concave du Profil Designer iPhysio® permet l'augmentation des tissus mous et crée un joint d'étanchéïté pour plus de stabilité osseuse. Son profil convexe maintient l'espace biologique en soutenant les papilles et la ligne gingivale.

2

RÉUSSIR SES EMPREINTES

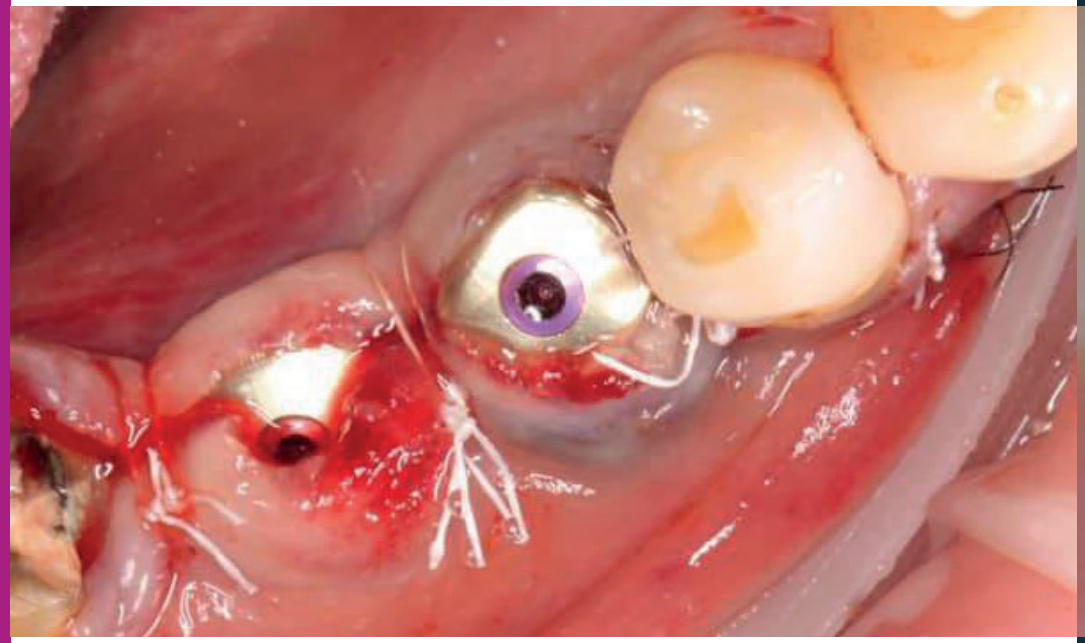

NON

OUI

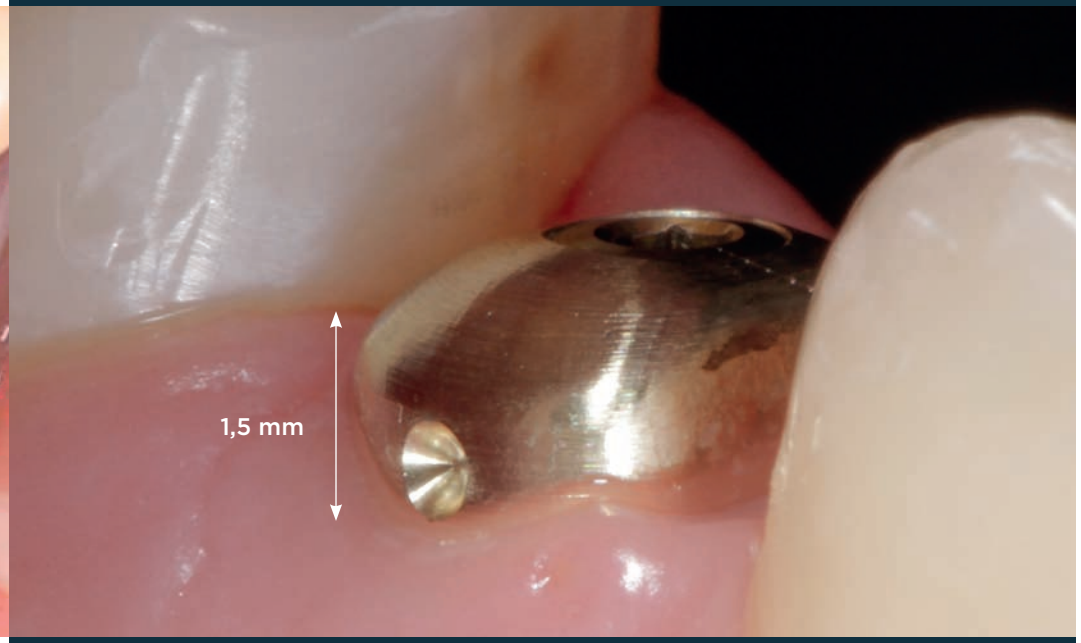

Placer à 1,5 mm minimum au dessus des tissus mous

Pour garantir la parfaite reconnaissance du Profile Designer iPhysio® par le scanner intra-oral, il ne doit pas être recouvert par les tissus lors de la prise d'empreinte.

3

PRÉSERVER LES PAPILLES GINGIVALES

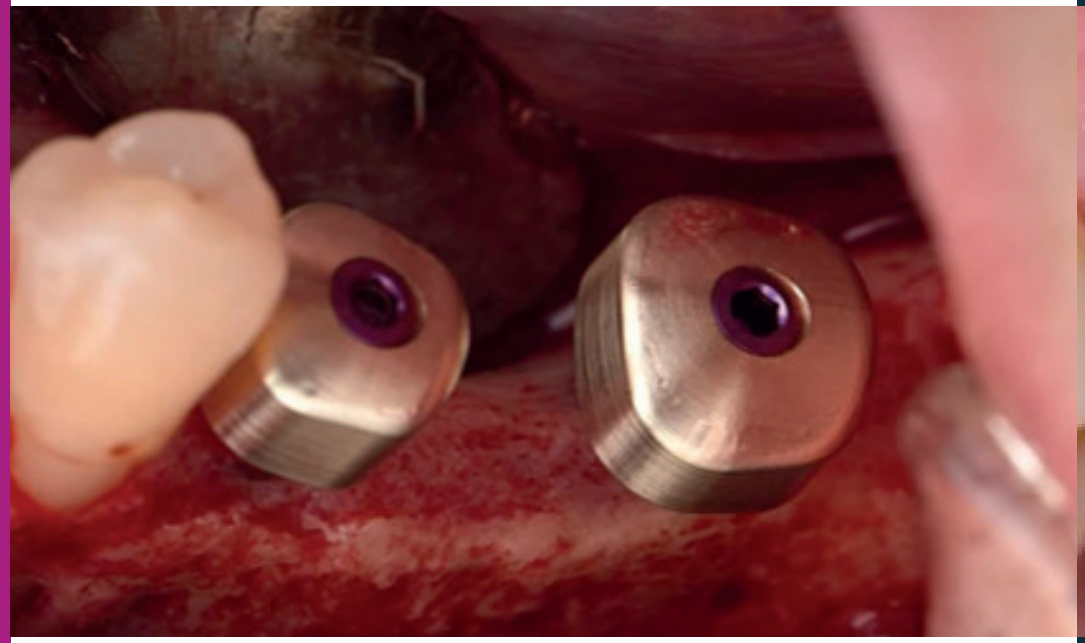

NON

OUI

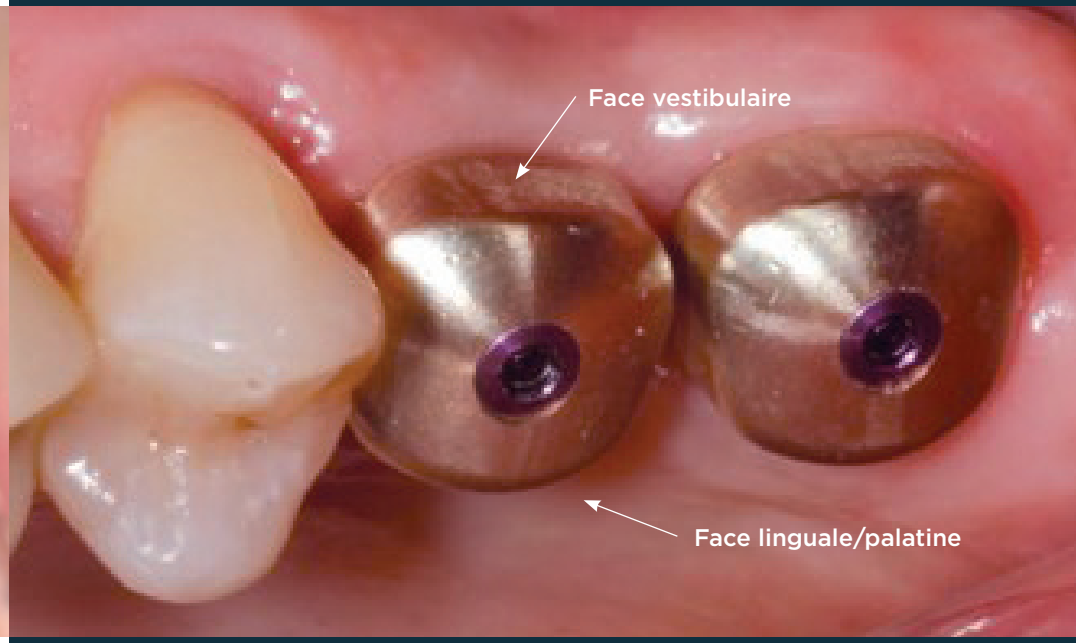

Préserver les papilles gingivales grâce à la bonne orientation du Profile Designer iPhysio®

Le Profile Designer iPhysio® dispose de deux faces différentes, l'une vestibulaire, l'autre linguale/palatine. Bien positionner le Profile Designer iPhysio® c'est être en adéquation idéale avec l'anatomie naturelle des dents.

4

SÉCURISER L'ADAPTATION PROTHÉTIQUE ET L'OCCLUSION

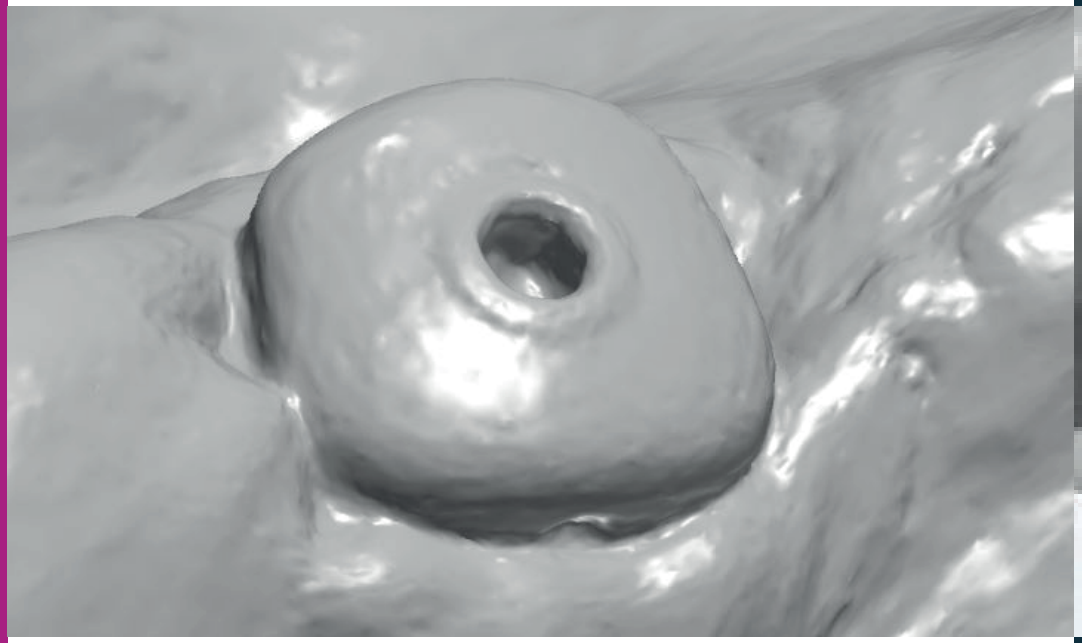

NON

OUI

Une surface lisse est la garantie d'un Profile Designer iPhysio® correctement engagé

Pour garantir une adéquation parfaite entre le berceau prothétique du Profile Designer iPhysio® et la restauration finale, il est vivement conseillé de resserrer systématiquement la vis avant une prise d'empreinte et de controler l'insertion à l'aide d'une radio rétro-alvéolaire.

5

DEUX IPHYSIO® ADJACENTS DOIVENT ÊTRE DISJOINTS

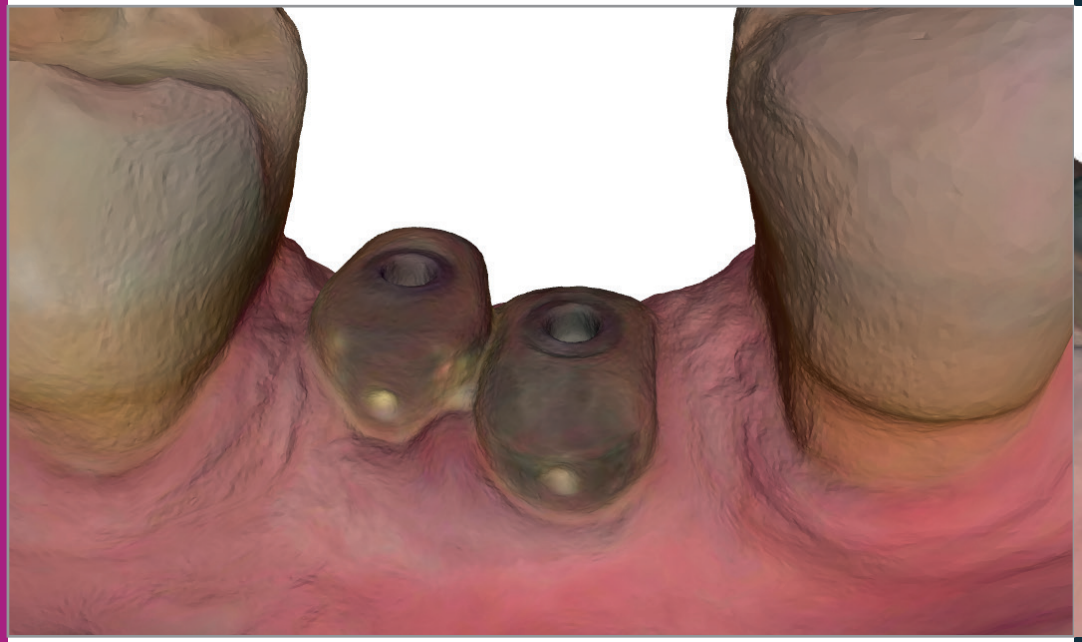

NON

OUI

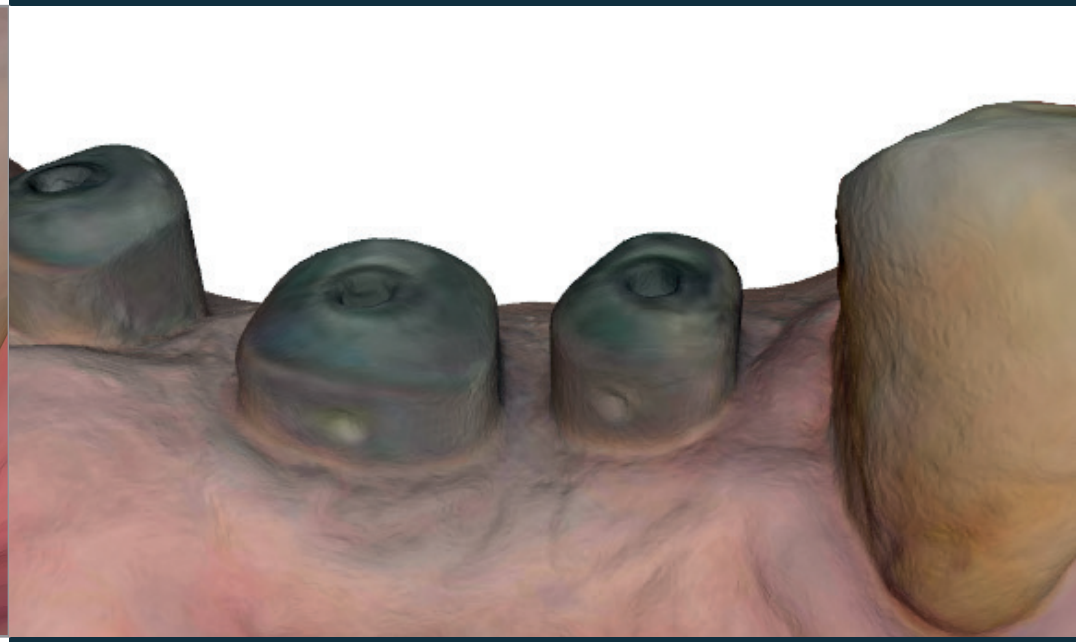

Pour que le scanner arrive à les identifier individuellement, les iPhysio® doivent être espacés

Si ils sont en contact, le scanner les confond en une seule pièce qui ne pourra être reconnue lors du matching avec la bibliothèque. Cela crée également une incertitude sur leur bon ajustement dans la connectique de l'implant.

6

FAIRE UNE PHOTO HD POUR TRANSMETTRE LES BONNES INFORMATIONS

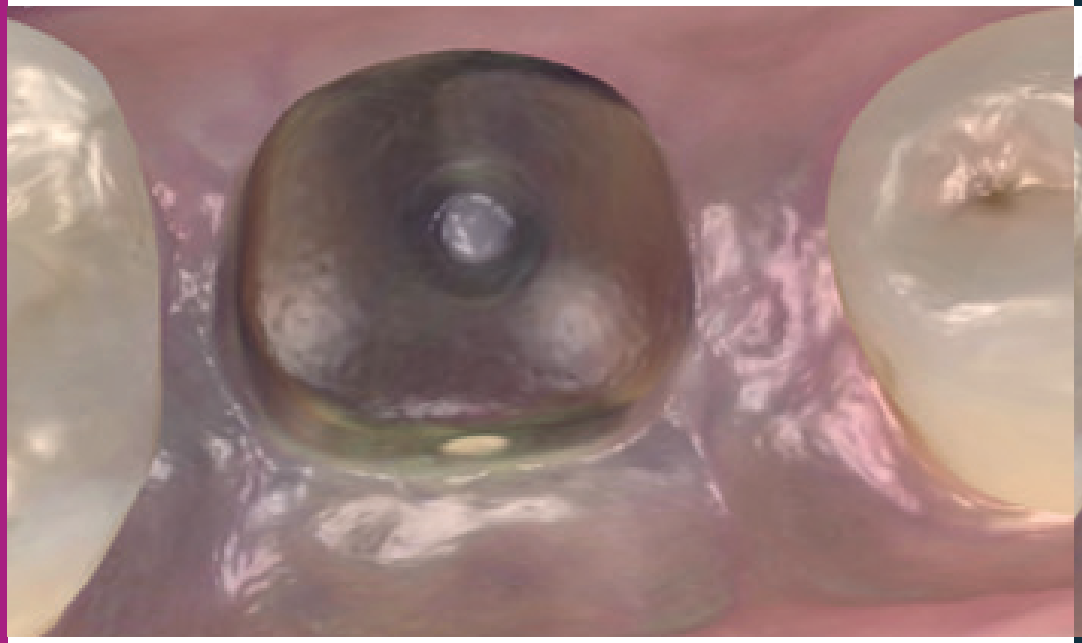

NON

OUI

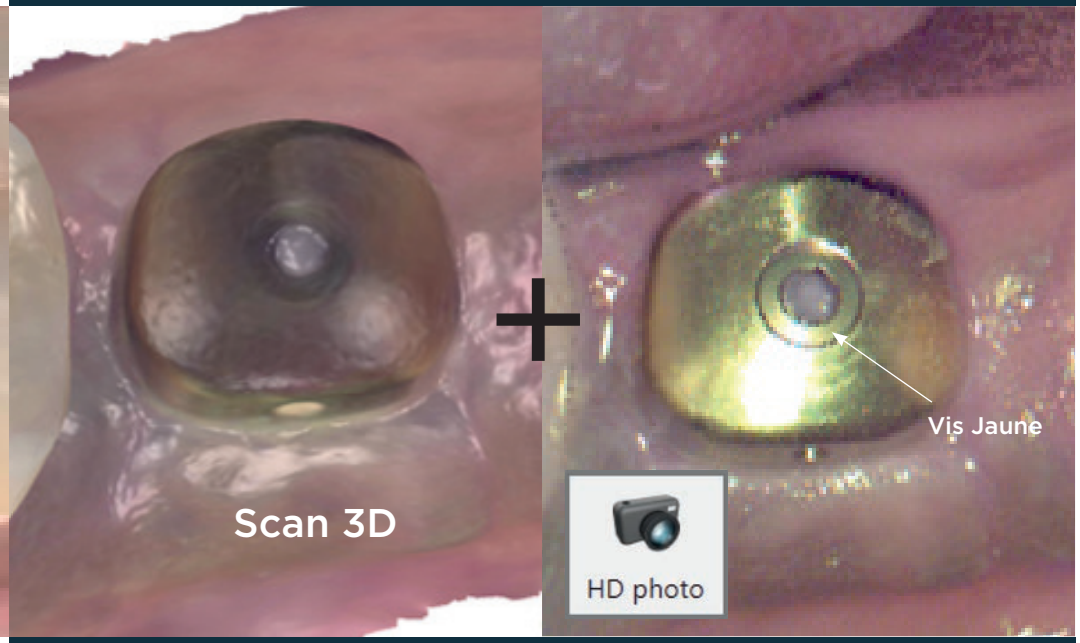

**La photo HD,
un complément indispensable à votre scan**

La transmission des bonnes informations dimensionnelles du Profile Designer iPhysio® est indispensable. Une photo HD permet de confirmer la couleur de la vis et ainsi d'éviter tout problème de malocclusion au niveau de la prothèse définitive. Dans le cas ci-dessus, la vis est jaune.

7

BIEN COMMUNIQUER AVEC SON LABORATOIRE

NON

Restorations			
Types	FDI	Type	Design settings
	36	Screw Retained Crown	AbutmentScrewRetainedCrown
Material	Emax		
Shade	A3		
Manufacturer	Euroteknika		
Connection	NP		
System	Naturall+		

Technical information:			
Order form settings file(s) IDs:	8e530ffe-2884-4a4c-b3df-a5aa00f0c33d_Lyra_Implanto_Lyra_Implanto_V33		
Order form settings file(s):			
Clinic ID:	02851		
Scan files	**Scan type**	**File name**	**Date**
	LowerJawScan	LowerJawScan.DCM	11/03/2021 18:39:53
	UpperJawScan	UpperJawScan.DCM	11/03/2021 18:40:38
	BiteScan	BiteScan.DCM	11/03/2021 18:41:25

Patient images:

OUI

Comments
Cr transvissée sur implant naturactis , iphysio B2 , teinte A3

Restorations			
Types	FDI	Type	Design settings
	25	Screw Retained Crown	Zr veneered Screw Retained Crown
Material	Zirconia - veneered		
Shade	A3		
Manufacturer	Euroteknika		
Connection	NP		
System	Naturall+		

Technical information:			
Order form settings file(s) IDs:	8e530ffe-2884-4a4c-b3df-a5aa00f0c33d_Lyra_Implanto_Lyra_Implanto_V33		
Order form settings file(s):			
Clinic ID:	1850601950		
Scan files	**Scan type**	**File name**	**Date**
	LowerJawScan	LowerJawScan.DCM	9/16/2021 3:42:04 PM
	UpperJawScan	UpperJawScan.DCM	9/16/2021 3:43:43 PM
	BiteScan	BiteScan2.DCM	9/16/2021 3:44:30 PM

Un simple commentaire sur le bon de commande assure la bonne réalisation de la prothèse

La transmission des bonnes dimensions du Profile Designer iPhysio® est indispensable. Dans la case « Comments », indiquez le type de Profile Designer iPhysio® et la référence exacte pour éviter toutes confusions.

8

PRÉSERVER LA RÉSINE DE VOTRE PROTHÈSE PROVISOIRE

NON

OUI

Le pilier provisoire vous permet un retrait facile de la prothèse provisoire lors de sa réalisation

Pour préserver la résine de votre prothèse provisoire lors du retrait pour les ajustements, conserver le pilier provisoire dans son intégralité.

9

ÉVITER LA MANIPULATION DES PIÈCES SUPRA-IMPLANTAIRES LORS DE L'AJUSTEMENT

NON

OUI

Un Profile Designer iPhysio® usagé et stérilisé est idéal pour finaliser la prothèse

Une fois la prothèse provisoire formée, la finalisation peut être réalisée en dehors de la bouche du patient sur un autre Profile Designer iPhysio® que vous aurez stérilisé au préalable. Cela comporte 2 avantages : vous préservez les tissus mous et vous n'usez pas inutilement le clip du pilier.

10

UTILISER LA VIS POUR ENLEVER LE PROFILE DESIGNER IPHYSIO®

NON

OUI

La vis est un bon préhenseur

Le Profile Designer iPhysio® dispose d'une vis imperdable. Faites sortir légèrement cette vis et utilisez là comme préhenseur pour faciliter le retrait du Profile Designe iPhysio®. Ainsi, préservez vos tissus marginaux.

11

CONSERVER LE BERCEAU GINGIVAL LORS DE LA RESTAURATION FINALE

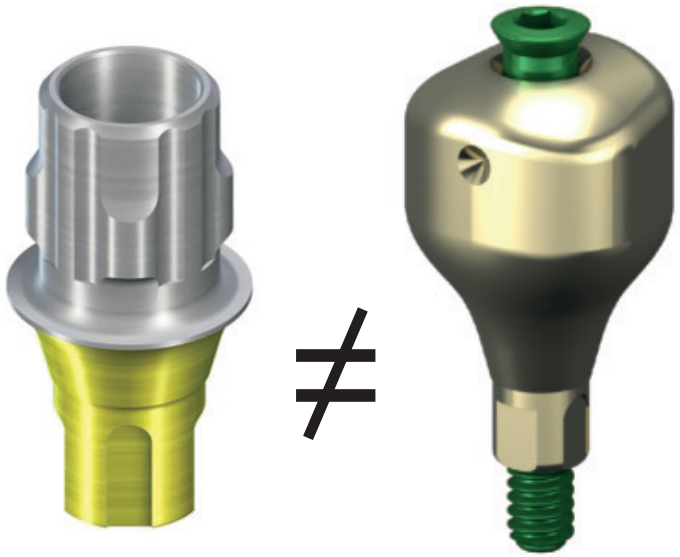

NON

OUI

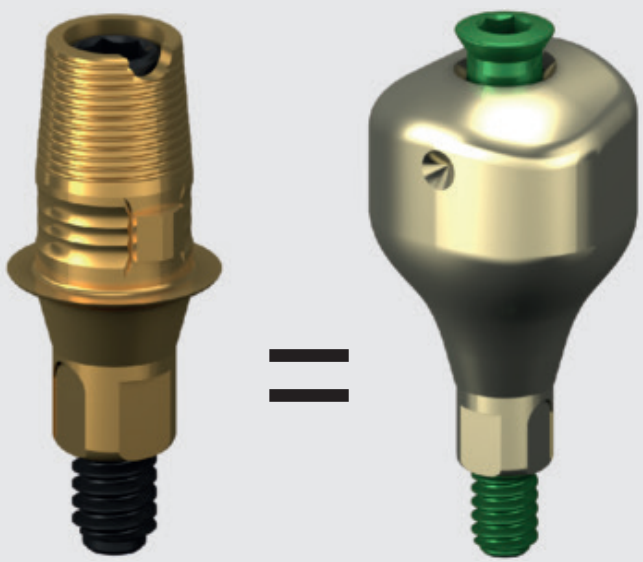

Sélectionnez une embase titane possédant le même profil d'émergence que le Profile Designer iPhysio® utilisé.

Les embases correspondantes à chaque Profile Designer iPhysio® dans chaque système implantaire sont indiquées dans nos bibliothèques. Afin de préserver les tissus mous et d'éviter toutes compressions tissulaires, le profil d'émergence créé lors de la cicatrisation des tissus mous est conservé au niveau de la restauration finale.

12

CONSERVER LES PROPRIÉTÉS DU REVÊTEMENT ZIRCONE

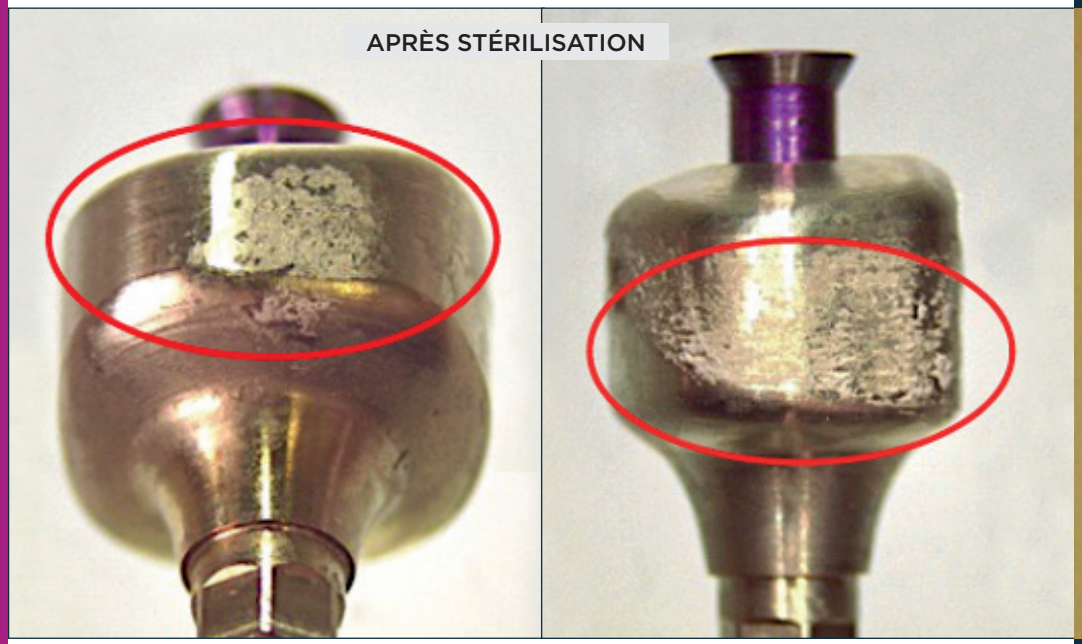

NON

OUI

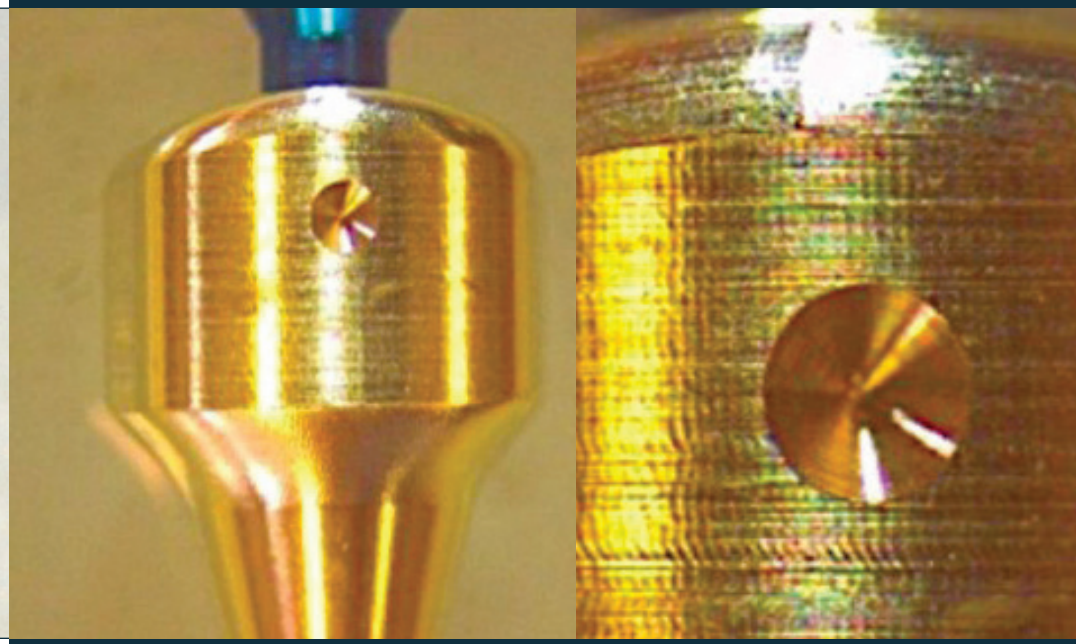

Le revêtement zircone est précieux

L'usage unique permet de conserver tout le bénéfice du revêtement zircone des Profile Designers iPhysio®, optimum pour l'interface avec les tissus mous.
Les études prouvent que la surface, malgré son revêtement en zircone, se détériore lors du protocole de nettoyage et de stérilisation. De plus, des résidus de solvants et de plaques dentaires, selon l'analyse de leur composition chimique, restent présents sur le Profile Designer iPhysio®.

POUR ALLER PLUS LOIN : UTILISER IBONE® AVEC IPHYSIO®

i bone iphysio®

MAÎTRISE DU STRESS OSSEUX ET MUQUEUX

L'implant iBone® est la continuité logique du concept iPhysio® au niveau osseux.
Il s'inscrit dans une approche biologique du traitement implantaire.
Il permet la création d'espaces de cicatrisation entre les spires,
et apporte une grande stabilité à l'implant pour maintenir ces espaces.

6 formes anatomiques

4 hauteurs

Scannables tous scanners

Revêtement zircone

11 connexions compatibles (principaux systèmes implantaires)

Pilier temporaire en peek

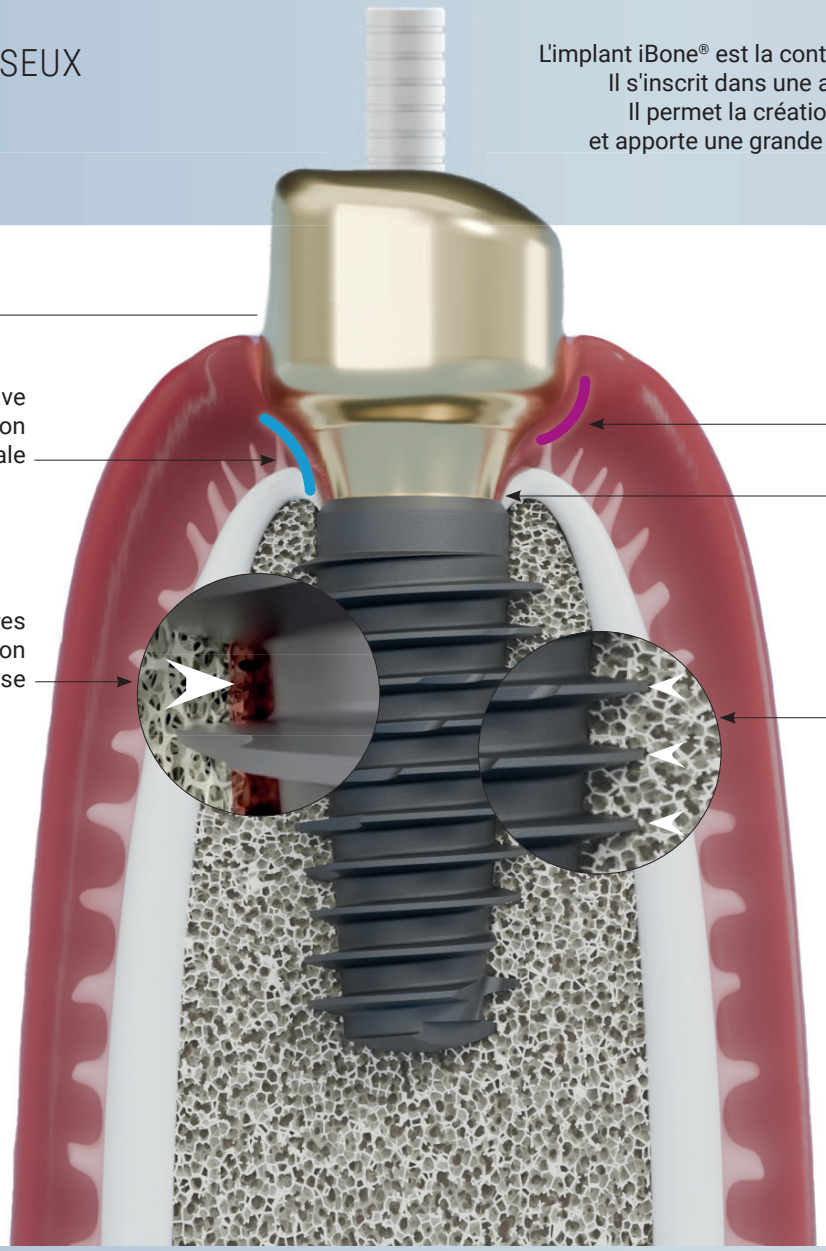

JUSQU'À -34% DE MÉTAL EN BOUCHE

COUPLE DE POSE -42% DE STRESS OSSEUX

JOINT BIOLOGIQUE CONTINU

Aide à prévenir la péri-implantite.

Favorise le pouvoir de cicatrisation du sang

Obtention d'un joint biologique continu

PROFILE DESIGNER

iphysio®

www.iphysio.dental | info@lyra.dental | Tél. +33(0) 1 76 42 00 60

EUROTEKNIKA S.A.S - 726 rue du Général de Gaulle, 74700 Sallanches (France)

Dispositifs médicaux et nécessaires (combinaison de dispositifs médicaux) de Classe I, conformes au Règlement Européen (EU) 2017/745 (marquage CE), et de dispositifs médicaux de classe IIa et IIb, conformes à la Directive Européenne 93/42/CEE (marquage CE 0459) et/ou au Règlement Européen (EU) 2017/745 (marquage CE 0425). Non remboursés par la Sécurité Sociale, ils doivent être utilisés par des professionnels de la santé bucco-dentaire. Lire attentivement la notice d'instructions et le manuel d'utilisation ou la technique opératoire.

LYRA ETK
DIGITAL DENTAL PROTOCOLS
Simple . Safe . Accessible

DOC_ETK_Code iPhysio_FR_I02_2024_12